




Le partenaire
médical

MANUEL D'UTILISATION

PESE PERSONNE PLAT

Modèle Batz référence C 152 200

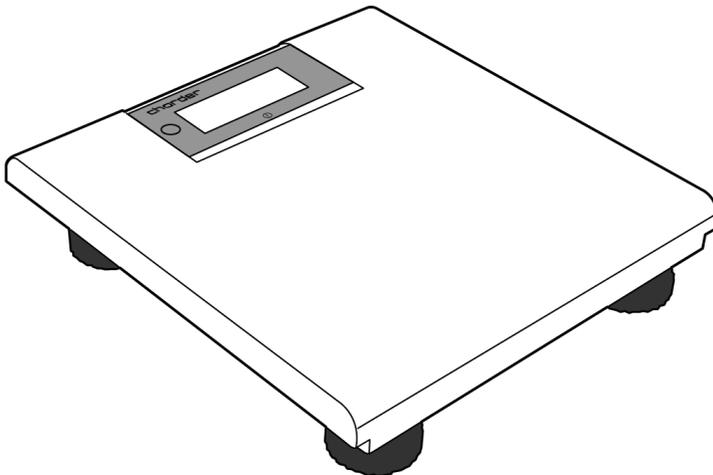

Veuillez garder le manuel d'instructions à portée de main tout le temps pour référence future.

Explication des symboles graphiques sur l'étiquette/l'emballage

	<p>Attention, consulter les documents d'accompagnement avant utilisation</p>		<p>Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, conformément à la directive 2002/96/CE</p>
	<p>Fabricant de dispositifs médicaux</p>		<p>Année de fabrication du dispositif médical</p>
	<p>Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation et l'utilisation, et suivez les instructions d'utilisation.</p>		<p>Équipement électromédical avec pièce appliquée de type B</p>
	<p>Numéro de catalogue de l'appareil</p>		<p>Représentant autorisé dans la Communauté européenne</p>
	<p>Numéro de lot ou de lot du fabricant</p>		<p>Ce produit est un dispositif médical</p>
	<p>Matricule</p>		<p>Identification unique du dispositif</p>
		<p>Le produit est conforme à la directive 93/42/CEE telle que modifiée par la directive 2007/47/CE sur les dispositifs médicaux. Le numéro à quatre chiffres fait référence à l'organisme notifié.</p>	
		<p>L'appareil est conforme aux exigences de l'Organisation internationale de métrologie légale (classe III) (modèles vérifiés uniquement)</p>	
		<p>L'appareil est conforme aux directives CE (modèles vérifiés uniquement)</p> <p>M: Label de conformité conforme à la directive 2014/31/UE pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique</p> <p>18: Année au cours de laquelle la vérification de la conformité a été effectuée et le label CE a été appliqué. (ex: 18=2018)</p> <p>0122: Fait référence à un organisme notifié pour la métrologie</p>	

Avis de droit d'auteur

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taïwan

Téléphone: +886-4-2406 3766

Télécopie : +886-4-2406 5612

Site Web : www.chardermedical.com Courriel : info_cec@charder.com.tw

Droits d'auteur© Charder Electronic Co., Ltd. Tous droits réservés.

Ce manuel d'utilisation est protégé par le droit d'auteur international. Tout le contenu est sous licence et l'utilisation est soumise à l'autorisation écrite de Charder Electronic Co., Ltd. (ci-après Charder) Charder n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des exigences énoncées dans ce manuel. Charder se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression dans le manuel sans préavis et de modifier l'extérieur de l'appareil à des fins de qualité sans le consentement du client.



Charder Electronic Co., Ltd.
No 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taïwan

SOMMAIRE

I. Notes de sécurité	5
A. Informations générales	5
B. Directives CEM et déclaration du fabricant.....	8
II. Installation.....	12
A. Insertion de piles	12
B. Utilisation de l'adaptateur	13
III. Indicateur	14
IV. Utilisation de l'instrument	15
A. fonctionnement de base.....	15
B. Zéro	15
V. Dépannage	16
VI. Spécifications	19
A. Renseignements sur l'appareil	19
B. Normes relatives aux adaptateurs	19
V Déclaration de conformité	20



I. Notes de sécurité

A. Informations générales

Merci d'avoir choisi cet instrument de marque Charder. Il est conçu pour être facile et simple à utiliser, mais si vous rencontrez des problèmes non abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre revendeur ou bien notre société Abilanx.

Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence. Il contient des instructions importantes concernant l'installation, l'utilisation correcte et l'entretien.

Utilisation prévue

Cet appareil est destiné à mesurer le poids de patients qui peuvent se tenir debout sans assistance, pour le diagnostic des problèmes liés au poids par des professionnels.

Manutention générale

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane, solide et non glissante.
- L'utilisation sur des surfaces molles (ex: tapis) peut entraîner des résultats inexacts.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement verrouillées et serrées avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil est destiné à mesurer un sujet à la fois.

Consignes de sécurité

Avant de mettre l'appareil en service, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des instructions importantes pour l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des instructions suivantes :

- Les piles doivent être tenues à l'écart des enfants. En cas d'ingestion, consultez rapidement un médecin.
- L'appareil a une durée de vie prévue de 5 ans lorsqu'il est correctement manipulé, entretenu et inspecté périodiquement conformément aux instructions du fabricant.
- Respectez toujours les réglementations appropriées lors de l'utilisation de composants électriques soumis à des exigences de sécurité accrues.
- Une mauvaise installation rendra la garantie nulle et non avenue.

- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'alimentation correspond à l'alimentation secteur.
- L'appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Respecter les températures ambiantes admissibles pour l'utilisation
- L'appareil répond aux exigences de compatibilité électromagnétique. Ne pas dépasser les valeurs maximales spécifiées dans les normes applicables.

Environnemental

- Toutes les piles contiennent des composés toxiques; les piles doivent être éliminées par l'intermédiaire d'organismes compétents désignés. Les piles ne doivent pas être incinérées.

Nettoyage

- La surface de l'appareil doit être nettoyée à l'aide de lingettes à base d'alcool. Les liquides nettoyeurs corrosifs ne doivent pas être utilisés. Les nettoyeurs haute pression ne doivent pas être utilisés.
- N'utilisez pas de grandes quantités d'eau lors du nettoyage de l'appareil, car cela pourrait endommager l'électronique interne.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation secteur avant de le nettoyer.

Entretien

- Veuillez contacter Abilanx ou votre revendeur pour un entretien et une vérification périodique annuelle obligatoire.
- L'appareil ne nécessite pas d'entretien de routine. Cependant, une vérification régulière de l'exactitude est recommandée; fréquence à déterminer en fonction du niveau d'utilisation et de l'état de l'appareil. Si les résultats sont inexacts, veuillez contacter votre revendeur.

Garantie/Responsabilité

- La période de garantie est 24 mois, à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par l'une des raisons suivantes : stockage ou utilisation inapproprié ou inapproprié, installation ou mise en service incorrecte par le propriétaire ou des tiers, usure naturelle, changements ou modifications, manipulation incorrecte ou négligente, interférence chimique, électrochimique ou électrique.
- Tous les entretiens, inspections techniques et réparations doivent être effectués par un vérificateur/réparateur agréé.

Disposition

- Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être emmené à un point de collecte désigné pour l'électronique. De plus amples informations devraient être fournies par les autorités locales chargées de l'élimination des déchets.



Avertissement

- Seul l'adaptateur d'origine doit être utilisé avec l'appareil. L'utilisation d'un adaptateur autre que celui fourni par Abilanx peut provoquer un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne sertissez pas le câble d'alimentation et évitez les arêtes vives.
- Ne surchargez pas la cabine d'extension connectée à l'appareil.
- Acheminez les câbles avec précaution, pour éviter les trébuchements.
- Gardez l'appareil à l'écart des liquides.
- Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble.
- Utilisez uniquement une prise correctement câblée (100-240VAC) et n'utilisez pas de câble d'extension à prises multiples.
- Ne démontez ni ne modifiez en aucun cas l'appareil, car cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures et nuire à la précision des mesures.
- Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une chaleur intense. Des températures excessivement élevées peuvent endommager l'électronique interne.

Rapports d'incidents

- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant, au représentant de l'UE (si le dispositif est utilisé dans un État membre de l'UE) et à l'autorité compétente de l'État membre de l'utilisateur/du sujet.

B. Lignes directrices CEM et déclaration du fabricant

Lignes directrices et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques		
L'échelle au sol sur pied MS4202L est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
Essai d'émission	Conformité	Guidage électromagnétique de l'environnement
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'appareil utilise l'énergie RF uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences dans les équipements électroniques à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	L'appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension / émissions de scintillement IEC 61000-3-3	Conformité	

Orientation et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique			
L'échelle au sol sur pied MS4202L est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau d'essai IEC 60601	Niveau de conformité	Guidage électromagnétique de l'environnement
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	<u>\pm contact 8 kV</u> <u>\pm 2 kV, \pm 4 kV, \pm 8 kV \pm 15 kV air</u>	<u>\pm contact 8 kV</u> <u>\pm 2 kV, \pm 4 kV, \pm 8 kV \pm 15 kV air</u>	Les planchers doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30%

Transitoire/rafale électrique rapide IEC 61000-4-4	± 2kV pour lignes d'alimentation électrique + 1kV pour les lignes d'entrée/sortie	+ 2kV pour les lignes d'alimentation électrique + 1kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur devrait être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Surtension IEC 61000-4-5	± ligne(s) 1kV à ligne(s) ± ligne(s) 2kV à la terre	+ Ligne(s) 1kV à ligne(s) + Ligne(s) 2kV vers la terre	La qualité de l'alimentation secteur devrait être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Baisses de tension, courtes interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation IEC 61000-4-11	<u>0% UT pour 0,5 cycle</u> <u>0% UT pour 1 cycle</u> <u>70% UT (30% de trempette dans UT) pendant 25 cycles</u> <u>0% UT pendant 5 s</u>	<u>0% UT pour 0,5 cycle</u> <u>0% UT pour 1 cycle</u> <u>70% UT (30% de trempette dans UT) pendant 25 cycles</u> <u>0% UT pendant 5 s</u>	La qualité de l'alimentation secteur devrait être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur de l'appareil a besoin d'un fonctionnement continu pendant les interruptions du secteur, il est recommandé que l'appareil soit alimenté à partir d'un alimentation non éruvable ou une batterie.
Fréquence de puissance (50/60 Hz) champ magnétique IEC 61000-4-8	<u>30 A/m</u>	<u>30 A/m</u>	Les champs magnétiques de fréquence de puissance de l'appareil doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique .
NOTE UT est la tension secteur a.c. avant l'application du niveau d'essai.			

Orientation et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

L'échelle au sol sur pied MS4202L est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau d'essai IEC 60601	Niveau de conformité	Guidage électromagnétique de l'environnement
-----------------	--------------------------	----------------------	--

<p>RF conduite CEI 61000-4-6</p> <p>RF rayonnée IEC 61000-4-3</p>	<p>3 Vrms 150 KHz à 80 MHz</p> <p><u>6 V dans les bandes ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz</u> 80 % AM à 1 kHz</p> <p>3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz</p>	<p>3 Vrms 150 KHz à 80 MHz</p> <p><u>6 V dans les bandes ISM comprises entre 0,15 MHz et 80 MHz</u> 80 % AM à 1 kHz</p> <p>3 V/m <u>80 MHz à 2,7 GHz</u></p>	<p>Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près d'une partie de l'appareil, y compris des câbles, que la distance de séparation recommandée calculée par l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.</p> <p>Distance de séparation recommandée :</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz à 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz à 2,5 GHz</p> <p>Où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).</p> <p>L'intensité du champ des émetteurs RF fixes, telle que déterminée par une étude électromagnétique, devrait être inférieure au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquence.</p> <p>Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement marqué du symbole suivant:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	---	--	---

NOTE1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.

NOTE2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

- a Les intensités de champ des émetteurs fixes, telles que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, la radio AM et FM et la diffusion télévisée ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site devrait être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le dispositif est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'appareil doit être autorisé à vérifier le fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l'appareil.
- b Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre l'équipement de communication RF portable et mobile et l'échelle de plancher sur pied MS4202L

Le dispositif est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l'appareil comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur	Distance de séparation selon la fréquence du transfert m		
	150 kHz à 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
Dans			
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs évalués à une puissance de sortie maximale non indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où p est la puissance nominale de sortie maximale du émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.


REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

II. Installation


L'appareil peut être utilisé une fois les piles installées (ou l'adaptateur branché).

A. Insertion de piles


1. Localisez le couvercle de la batterie au bas de l'appareil

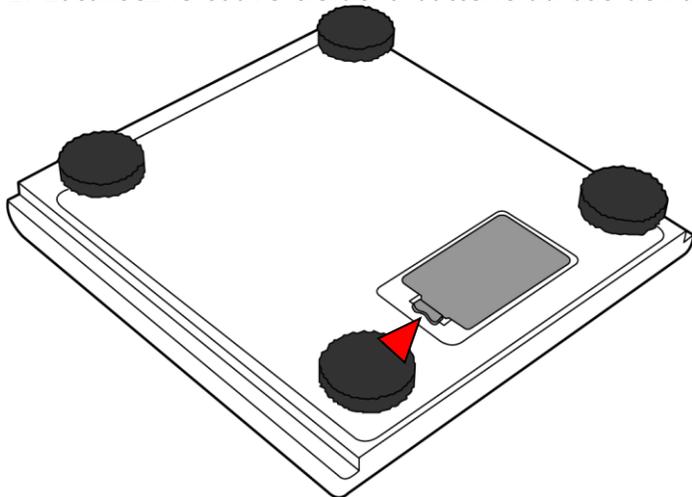

2. Retirez le couvercle de la batterie. Insérez les piles. Assurez-vous que la polarité est correcte.

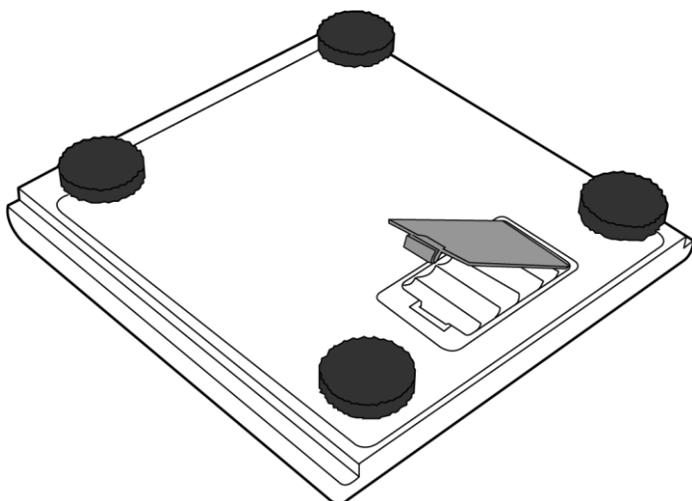


3. Insérez toutes les piles. Fermez le couvercle et tournez l'instrument vers le haut.

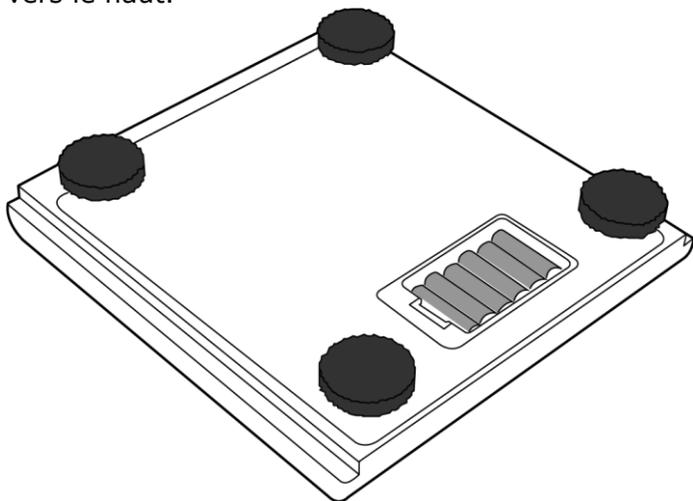


B. Utilisation de l'adaptateur

L'appareil peut être alimenté via un adaptateur à l'aide du port situé à l'arrière de l'appareil. Branchez l'adaptateur dans l'appareil avant de le brancher sur le secteur.

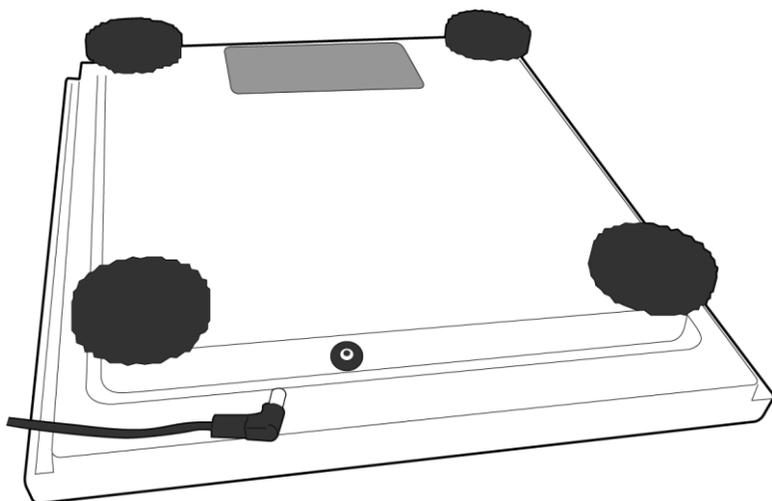

III. Indicateur

Indicateur et fonctions clés

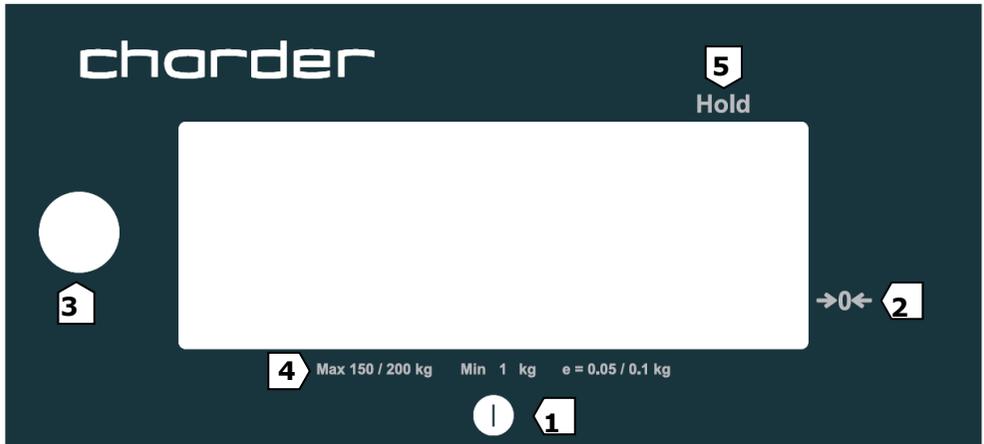

Fonctions clés

1. Marche /Zéro/Arrêt : Allumez et éteignez l'appareil.
Appuyez longuement pour éteindre.

Symboles d'indicateur

2. L' Indicateur zéro: l'appareil est à zéro
3. L' Indicateur de niveau : déterminez si l'appareil est de niveau
4. Spécifications : Capacité et graduation de l'appareil
5. L' Hold (facultatif) : déterminez si le mode de verrouillage du poids (hold) est actif


IV. Utilisation de l'appareil

A. Fonctionnement de base

Il existe 2 méthodes pour allumer l'appareil :

Activation automatique

1. Appuyez sur le plateau pendant 2 secondes pour allumer l'appareil
2. Laisser la plateforme de mesure

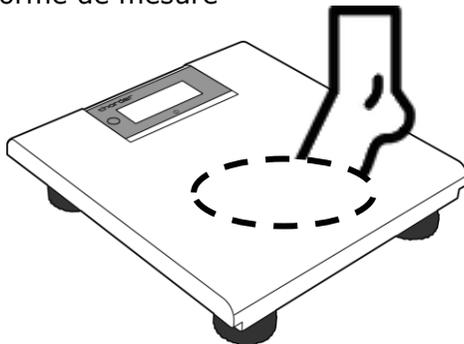

3. L'appareil effectuera automatiquement l'auto-allumage.

Allumage manuel

1. Appuyez **sur la touche [On / Zero / Off]** pour allumer l'appareil.
2. L'appareil effectuera automatiquement l'auto-allumage.

Remarque : Ne vous tenez pas sur la balance pendant que la balance effectue un auto-allumage.

Une fois que « 0,00 kg » apparaît sur l'indicateur, l'appareil est prêt pour la mesure.

Remarque: Si « 0,00 kg » ne s'affiche pas sur l'indicateur, appuyez sur la touche **[On / Zero / Off]** pour mettre à zéro l'appareil. Cette fonction peut être utilisée pour le poids correspondant à $\pm 2\%$ de la pleine capacité.

Remarque : Si le poids du sujet dépasse la capacité de l'instrument, l'indicateur affichera « Err » en raison d'une surcharge.

B. Zéro

La fonction zéro permet à l'utilisateur d'effacer la valeur résiduelle des objets du résultat de mesure de l'appareil. Zéro peut être utilisé lorsque le poids de l'objet est \leq à moins de 2 % de sa pleine capacité.

V. Dépannage

Défauts du produit

En cas de défaut ou problème lors de la première utilisation : contacter rapidement votre revendeur.

1. Si un défaut est constaté à la réception de l'unité, Abilanx se chargera de son remplacement via votre revendeur. En cas d'échec des réparations ou de la livraison de remplacement, les dispositions légales sont valables. La période de garantie est de deux ans, à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.

2. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par l'une des raisons suivantes : stockage ou utilisation inapproprié ou inapproprié, installation ou mise en service incorrecte par le propriétaire ou des tiers, usure naturelle, changements ou modifications, manipulation incorrecte ou négligente, interférence chimique, électrochimique ou électrique, sauf si les dommages sont imputables à une négligence de la part du fabricant.

Si l'appareil n'est pas couvert par la garantie, des frais d'entretien s'appliqueront, plus le coût des pièces et du transport.

Avant de contacter votre revendeur afin d'obtenir un service de réparation, nous vous recommandons d'envisager les procédures de dépannage suivantes :

Auto-inspection

1. L'appareil ne s'allume pas

- Si la batterie est épuisée, remplacez-la par de nouvelles piles
- Si les piles ne sont pas utilisées, vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement branché sur l'appareil. Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement branché sur le secteur.

2. Indicateur indiquant « 0000 » ZERO SPAN hors de portée

- Interférence due à des facteurs tels que la perturbation RF ou les vibrations du sol. Déplacez l'appareil vers un emplacement sans interférence et réessayez
- Plate-forme instable. Déplacez l'appareil vers un emplacement stable et réessayez
- Objets externes interférant avec la plate-forme de mesure. Effacer la plate-forme des objets et réessayer

- L'appareil peut ne pas fonctionner correctement sur les surfaces molles telles que les tapis ou les pelouses. Déplacez l'appareil à l'emplacement avec un sol solide et stable
- Si les étapes ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème, un réétalonnage peut être nécessaire pour corriger la précision du pesage.

Support distributeur requis

Si les erreurs suivantes se produisent, nous vous recommandons de contacter votre revendeur pour des services de réparation ou de remplacement :

1. L'appareil ne s'allume pas

- Touche marche/arrêt défectueuse
- Fils cassés ou endommagés provoquant un court-circuit ou une connexion défectueuse
- Épuisement des fusibles de sécurité
- Adaptateur défectueux

2. Dommages à l'indicateur

- Les défauts matériels possibles incluent: écran LCD délavé , texte flou, écran arc-en-ciel maculé, affichage décimal incorrect
- Impossible de lire les données
- L'indicateur indique « Err. E » après la mise sous tension de l'appareil
- Les touches ne répondent pas
- Dysfonctionnement de Buzzer

Messages d'erreur

Message d'erreur	Raison	Action
	Avertissement de batterie faible La tension de la batterie est trop faible pour faire fonctionner l'appareil	Remplacez les piles ou branchez l'adaptateur.
	Surcharger La charge totale dépasse la capacité maximale de l'appareil	Réduisez le poids sur la plate-forme de mesure et réessayez
	Erreur de comptage Signal anormal des cellules de charge	Erreur normalement causée par un capteur de charge ou un câblage défectueux. Veuillez contacter votre revendeur.
	Poids sur la plate-forme de mesure lorsque l'appareil est allumé	Supprimer tous les objets et redémarrer l'instrument.

VI. Spécifications du produit

A. Informations sur l'appareil

Modèle		C152 200/MS4202L
Mesure du poids	Capacité	0-150 kg x 50g 150-200 kg x 100g
	Exactitude	±1,5
	Ecran LCD	Écran LCD de 1,0 pouce (5 chiffres)
	OIML	Classe III
Dimension de l'appareil		325(W) x 310(D) x 50(H) mm
Poids de l'appareil		3.4 kg (sans batterie)
Fonctions touches		Activé/Zéro/Désactivé
Alimentation		6 piles AA / Adaptateur secteur
Température et humidité de fonctionnement		5°C ~ 35°C 15% / 85% HR
Accessoires standard		Manuel d'utilisation x1
Accessoires en option		Adaptateur secteur, Sac de transport

B. Normes relatives aux adaptateurs d'alimentation



Avertissement

L'appareil n'est compatible qu'avec les adaptateurs d'alimentation spécifiés dans le bloc en pointillés ci-dessous.

TENSION DE L'AMPÈRE	N° DE DESSIN :	N° DE TYPE / N° DE MODÈLE HOMOLOGUÉ CE:	TYPE	Prise adaptateur
12V 1A	AD-8095	UE24WCP1-120200SPA	NOUS	 90 - degree
12V 1A	AD-8095	UE24WCP1-120200SPA	EU	
12V 1A	AD-8095	UE24WCP1-120200SPA	ROYAU ME- UNI	
12V 1A	AD-8095	UE24WCP1-120200SPA	AU	

VII. Déclaration de conformité

Ce produit a été fabriqué conformément aux normes européennes harmonisées, en suivant les dispositions des directives ci-dessous:

	93/42/CEE telle que modifiée par la directive 2007/47/CE sur les dispositifs médicaux
	2014/31/EU Directive sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique

S'il vous plaît voir le document séparé montrant sur l'autocollant de l'appareil pour le marquage CE ci-dessus.

Représentant autorisé de l'UE :



Obelis s.a.

Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium

IMPORTATEUR pour le marché Français

ABILANX

Park Avenue Rue Léon Griffon 56890 Saint Avé France

Tél (+33) 02 97 63 70 46 Fax : (+33) 02 97 63 74 90

contact@abilanx.com www.abilanx.com



Fabriqué par:
Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taïwan (R.O.C.)

CD-IN-00477 REV001 01/2022